



Doküman Kodu:

P.16-FR.02

İlk Yayın Tarihi:

16.07.2019

Revizyon Tarihi-No:

00.00.0000-00

Güncelleme Tarihi:

SWOT PEST ANALİZİ FORMU

Sayfa : 1/4

SWOT ANALİZİ

OLUMLU

OLUMSUZ

STRENGTH GÜÇLÜ YANLAR

WEAKNESS ZAYIF YANLAR

KURUM İÇİ

- Alanında tecrübeli ve yetkin personel bulundurması
- Güçlü Cihaz envanteri
- 2015'ten beri Akredite olmamız
- Hizmet kapsamının ve akredite parametrelerinin çok geniş olması
- TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 kapsamında akredite olması
- Kamu olması sebebi ile maaş ödemelerinin sorun olmaması.
- Yönetim desteği
- Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili laboratuvar olması
- Personel sayısının yeterli olması

- Binanın yetersiz olması
- Satın alma süreçlerinde yaşanan gecikmeler
- 657 sayılı devlet memurlarının görev alması sebebiyle mesai dışı çalışmalarda yaşanan sıkıntılar
- Kreş olmaması
- Sosyal imkanların yetersiz olması
- Cihazlara ait teknik servislerin il içerisinde bulunmaması

OPPORTUNITIES FIRSATLAR

THREATS TEHDİTLER

Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz, kurum dışına çıkartılamaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Hazırlayan

Kontrol

Onay



Doküman Kodu:

P.16-FR.02

İlk Yayın Tarihi:

16.07.2019

Revizyon Tarihi-No:

00.00.0000-00

Güncelleme Tarihi:

SWOT PEST ANALİZİ FORMU

Sayfa : 2/4

KURUM DIŞI

- 6552 sayılı torba yasa ile taşeron personelinin özel sözleşmeli personel kadrosuna geçmesi ile sözleşme sürelerinin uzatılması.
- MELBES uygulaması.

- Cihaz teknik servis personelinin yetersiz olması ve hizmet kalitesinin düşük olması
- Kamuya bağlı bir laboratuvar olduğu için kontrol dışı personel değişikliklerin olması

Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz, kurum dışına çıkartılamaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
------------	---------	------

Doküman Kodu:

P.16-FR.02

İlk Yayın Tarihi:

16.07.2019

Revizyon Tarihi-No:


00.00.0000-00

Güncelleme Tarihi:

SWOT PEST ANALİZİ FORMU

Sayfa : 3/4

PEST ANALİZİ

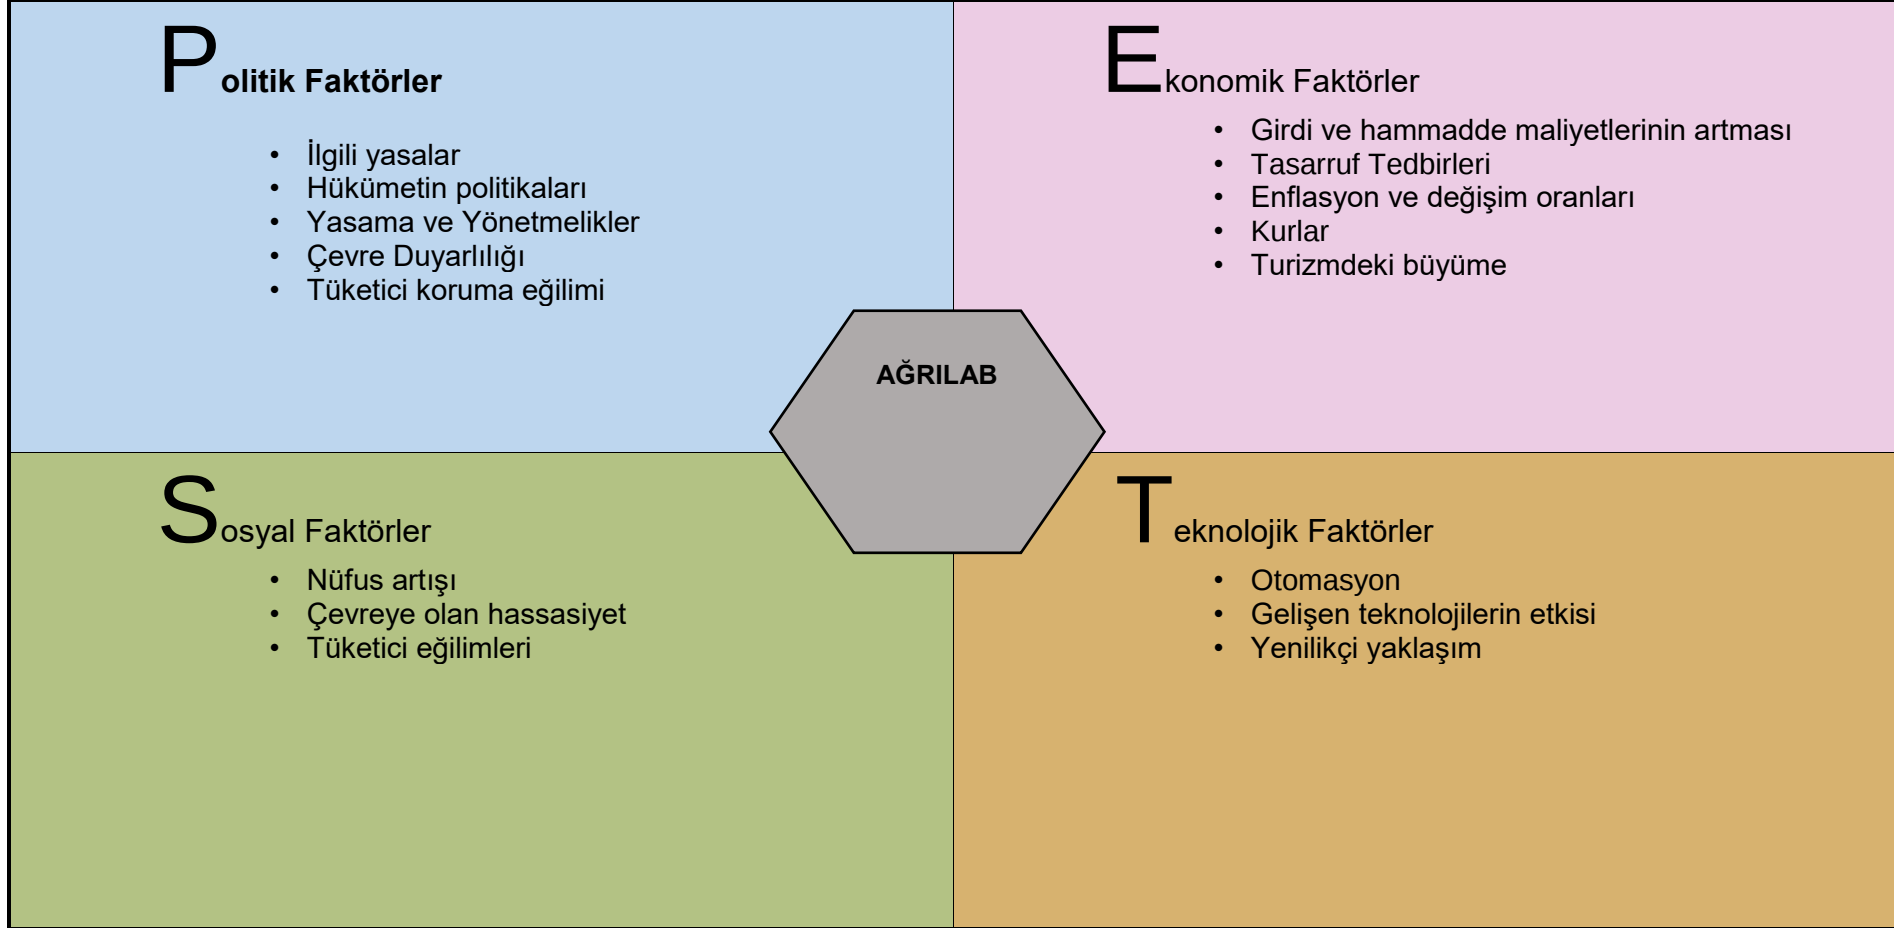


Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz, kurum dışına çıkartılamaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Hazırlayan

Kontrol

Onay

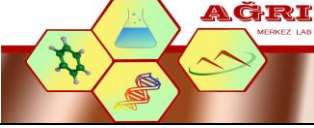

Doküman Kodu:

P.16-FR.02

İlk Yayın Tarihi:

16.07.2019

Revizyon Tarihi-No:

00.00.0000-00

Güncelleme Tarihi:

SWOT PEST ANALİZİ FORMU

Sayfa : 4/4

Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz, kurum dışına çıkartılamaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Hazırlayan

Kontrol

Onay